

R1600

REED **INSTRUMENTS**

Anémomètre à hélice

SMART 
Series

Manuel d'utilisation



REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com

Table des matières

Introduction	3
Qualité du produit.....	3
Sécurité	3
Déclaration FCC	4-5
<i>Déclaration FCC - Exposition aux rayonnements RF</i>	5
Déclaration IC.....	5
<i>Déclaration IC - Exposition aux rayonnements RF</i>	5
Caractéristiques	6
Comprend	6
Spécifications.....	7-8
Description de l'instrument	9
Description de l'affichage.....	10
Application REED Smart Series	11
Mode d'emploi	12-14
<i>Marche/Arrêt</i>	12
<i>Rétroéclairage</i>	12
<i>Établissement de la connexion Bluetooth^{MD}</i>	12
<i>Sélection de l'unité de mesure de la température et de la vitesse</i> <i>de l'air</i>	13
<i>Activation/désactivation de la fonction de maintien des données</i>	13
<i>Basculement entre l'humidité relative et le mode de vitesse de l'air..</i>	13
<i>Activer/désactiver la mise hors tension automatique</i>	14
Remplacement des piles.....	15
Applications.....	15
Accessoires et pièces de rechange.....	15
Entretien du produit.....	16
Garantie du produit	16
Mise au rebut et recyclage du produit.....	16
Service après-vente.....	17

Introduction

Merci d'avoir acheté cet anémomètre à hélice REED R1600, Bluetooth^{MD} Smart Series. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre instrument. En suivant les étapes indiquées dans ce guide, votre appareil de mesure vous assurera des années de service fiable.

Qualité du produit

Ce produit a été fabriqué dans une installation certifiée ISO9001 et a été calibré au cours du processus de fabrication afin de répondre aux caractéristiques de produit énoncées. Pour obtenir un certificat de calibration, veuillez communiquer avec le distributeur REED ou tout autre centre de service autorisé. Veuillez noter que des frais additionnels sont exigibles pour ce service.

Sécurité

- Ne jamais tenter de réparer ou de modifier votre instrument. Le démontage de ce produit peut entraîner des dommages qui ne seront pas couverts par la garantie du fabricant. Toute réparation doit être effectuée par un centre de service autorisé.
- Avertissement de champ magnétique; veuillez garder une distance minimale de 10cm (4 pouces) entre le stimulateur cardiaque et l'appareil de mesure.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement: Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

suite...

REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com

Déclaration FCC - Exposition aux rayonnements RF

Cet appareil est conforme aux limites d'intensité de rayonnements RF établie pour un environnement non contrôlé et est sans danger pour l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel.

Déclaration IC

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration IC - Exposition aux rayonnements RF

Cet appareil est conforme aux limites d'intensité de rayonnements RF canadienne établie pour un environnement non contrôlé et est sans danger pour l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel.

Caractéristiques

- Mesure la vitesse de l'air (m/s, pi/min, km/h et mi/h), la température et l'humidité d'air
- Facile à utiliser, conçu pour un fonctionnement à une seule main
- L'écran intégré offre une flexibilité d'utilisation sans appareil mobile
- L'endos magnétique permet de monter l'instrument sur des surfaces métalliques
- Fonction de maintien des données
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
- Support de trépied pour surveillance à long terme

Lorsqu'utilisé avec l'application REED Smart Series:

- Calcule le volume d'air
- Enregistreur de données en temps réel
- Fréquence d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur de 1 à 120 secondes
- La technologie Bluetooth^{MD} 5.0 assure la connectivité aux instruments jusqu'à une distance de 75m (246')
- Connectez, mesurez et enregistrez simultanément jusqu'à six instruments
- Configuration facile grâce à l'intégration automatique de l'application pour les instruments compatibles avec les REED Smart Series
- Exportez les données au moyen d'Excel ou de PDF et créez des rapports personnalisés pouvant être envoyés par courriel depuis un appareil mobile

Comprend

- Anémomètre à hélice
- Piles
- Capuchon de protection

REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com

Spécifications

Vélocité de l'air (anémomètre)

Gamme de mesures:

pi/min: 118 à 4 921

m/s: 0.6 à 25

km/h: 2.1 à 90

mi/h: 1.3 à 55.9

Précision:

pi/min $\pm(40\text{fpm} + 3.5 \%)$

m/s: $\pm(0.2\text{m/s} + 3.5 \%)$

km/h: $\pm(0.8\text{km/h} + 3.5 \%)$

mi/h: $\pm(0.5\text{mph} + 3.5 \%)$

Résolution:

pi/min: 1

m/s: 0.1

km/h: 0.1

mi/h: 0.1

Temperature

Gamme de mesures:

-20 à 60°C (-4 à 140°F)

Précision:

-20 à 0°C (-4 à 32°F): $\pm 0.8^\circ\text{C}$ (1.6°F)

0 à 60°C (32 à 140°F): $\pm 0.5^\circ\text{C}$ (1°F)

Résolution:

0.1°C/°F

Humidité

Gamme de mesures:

0 à 100 % RH

Précision:

20 à 80 % RH: $\pm 3.5 \%$ rdg.

0 à 20 % & 80 à 100 % RH: $\pm 5 \%$ rdg.

Résolution:

0.1% RH

Spécifications générale

Affichage:

Écran ACL multiligne nématique
torsadée noire améliorée (Enhanced
Black Twisted Nematic, EBTN)

Taille de l'affichage:

34mm (1.3")

Affichage rétroéclairé:

Oui

Fonction de maintien des données:

Oui


suite...

REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com


Capacités d'enregistrement de données:	Oui (avec l'application Smart Series)
Horloge en temps réel et horodatage:	Oui (avec l'application Smart Series)
Taux d'échantillonnage personnalisable:	Oui
Indicateur de dépassement supérieur:	Oui
Arrêt automatique:	Oui (réglable)
Trépied montable:	Oui
Support magnétique:	Oui
Indicateur de piles faibles:	Oui
Alimentation:	4 piles de AAA
Durée de vie de la pile:	Environ 50 heures (selon le temps d'échantillonnage)
Connectivité:	Bluetooth ^{MD} 5.0
Gamme Bluetooth ^{MD} :	Jusqu'à 75m (246')
Nombre maximal d'appareils connectés:	6
Logiciel:	Application REED Smart Series (iOS et Android)
Langues prises en charge par l'application:	Anglais, français
Certifications du produit:	CE, UKCA, FCC, IC ID
Altitude d'utilisation maximale:	2 000m (6 561')
Température de fonctionnement:	-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Température de stockage:	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Plage d'humidité de fonctionnement:	10 à 90 %
Plage d'humidité de stockage:	10 à 90 %
Dimensions:	175 x 38 x 25mm (6.9 x 1.5 x 1")
Poids:	108g (3.8oz)

Description de l'instrument

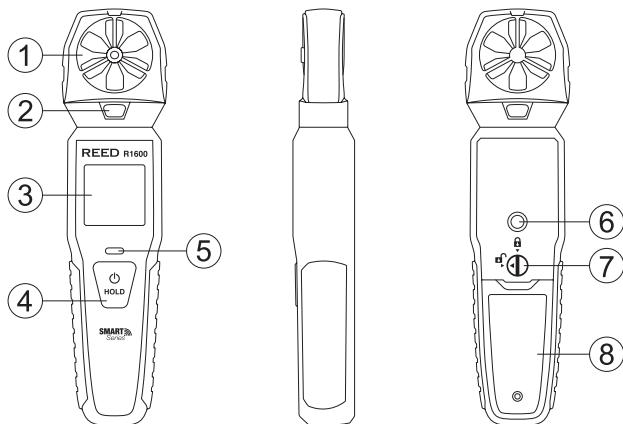

1. Capteur de débit d'air
2. Capteur de température et d'humidité
3. Affichage ACL
4. Bouton d'alimentation/maintien des données
5. Témoin de statut de voyant Bluetooth^{MD}
6. Vis de fixation de trépied
7. Verrou du couvercle à pile
8. Couvercle à pile

Description de l'affichage

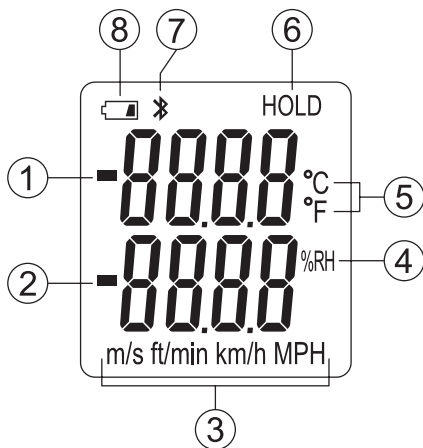

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Valeur de la mesure de température | 5. Unité de mesure de la température |
| 2. Valeur de mesure de la vitesse de l'air/de l'humidité relative | 6. Indicateur de maintien des données |
| 3. Unité de mesure de la vitesse de l'air | 7. Indicateur Bluetooth ^{MD} |
| 4. Unité de mesure de l'humidité | 8. Indicateur de piles faibles |

Application REED Smart Series


La série d'instruments Smart Series de REED peut être connectée sans fil à votre téléphone intelligent ou à votre tablette. Toutes les données de mesure sont transmises par Bluetooth^{MD} à l'application gratuite REED Smart Series. L'application permet également aux utilisateurs de générer des rapports et d'envoyer des informations par courriel directement à partir de votre appareil mobile.

Caractéristiques de l'application:

- La technologie Bluetooth^{MD} 5.0 assure la connectivité aux instruments jusqu'à une distance de 75m (246')
- Connectez, mesurez et enregistrez simultanément jusqu'à six instruments
- Configuration facile avec intégration automatique de l'application (appariement Bluetooth^{MD} non requis)
- Toutes les données de mesure sont affichées sous forme de lectures d'instruments, de tableaux ou de graphiques
- Enregistrer les données en format PDF ou Excel
- Créer des rapports personnalisés qui peuvent être enregistrés sur un appareil mobile ou envoyée par courriel

Pour en savoir plus et télécharger l'application REED Smart Series à partir de Google Playstore (Android) ou de l'App Store d'Apple (iOS), visitez www.REEDInstruments.com/cafr/smartseries.

Vous pouvez également rechercher l'application REED Smart Series directement à partir de votre appareil.

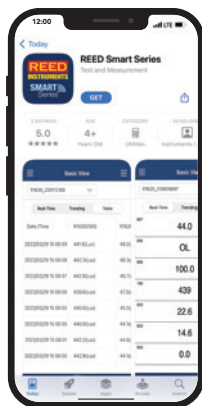

Les spécifications complètes et la compatibilité de système d'exploitation se trouvent sur la page de produit, à l'adresse www.REEDInstruments.com/cafr/r1600. Si vous avez des questions particulières concernant votre application et/ou des questions concernant la configuration et les fonctionnalités du logiciel, communiquez avec le distributeur autorisé le plus près ou le service à la clientèle par courriel à l'adresse info@reedinstruments.com ou par téléphone au 1-877-849-2127.

REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com

Mode d'emploi

Marche/Arrêt

Pour allumer l'appareil de mesure, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes. Pour arrêter l'appareil de mesure, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ quatre secondes.

Rétroéclairage

Après avoir mis l'appareil de mesure sous tension, le rétroéclairage de l'écran ACL s'allume automatiquement. Afin de préserver l'alimentation de la batterie, l'écran ACL s'éteindra après environ 15 secondes. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour remettre l'écran sous tension.

Établissement de la connexion Bluetooth^{MD}

1. Afin d'établir une connexion Bluetooth^{MD}, l'application REED Smart Series doit être installée sur votre appareil mobile.
2. Lorsque l'application est ouverte et que l'appareil de mesure est sous tension, l'appareil de mesure tentera automatiquement d'établir une connexion avec l'application. Jusqu'à ce que la connexion soit établie, le voyant d'état Bluetooth^{MD} clignotera en bleu.
3. Lorsque la connexion est établie, le voyant d'état Bluetooth^{MD} reste bleu et les lectures actuelles sont automatiquement affichées dans l'application.

Chaque appareil de mesure REED Smart Series est doté de la connectivité Bluetooth^{MD} 5.0 qui ne nécessite pas l'appariement des appareils de mesure avec un appareil. Si l'application est ouverte et que l'appareil de mesure est sous tension, une connexion sera automatiquement établie.

suite...

REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com

Sélection de l'unité de mesure de la température et de la vitesse de l'air

1. Lorsque l'appareil de mesure est sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que SET apparaisse, indiquant que l'appareil de mesure est en mode de sélection de l'unité de mesure.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour alterner entre Celsius et Fahrenheit. Une fois l'unité de mesure de température désirée sélectionnée, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour entrer en mode d'unité de mesure de vitesse de l'air.
3. Pour basculer entre m/s, ft/min, km/h et mil/h, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. Une fois que l'unité de mesure de la vitesse de l'air désirée est sélectionnée, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour reprendre le fonctionnement normal.

Activation/désactivation de la fonction de maintien des données

1. Appuyez sur le bouton de maintien des données pour geler la lecture actuelle sur l'affichage.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre le fonctionnement normal.

Basculer entre l'humidité relative et le mode de vitesse de l'air

L'écran ACL affichera toujours la température sur la ligne principale. La conduite secondaire peut afficher l'humidité relative ou la vitesse de l'air. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour basculer entre l'humidité relative et la vitesse de l'air.

suite...

Activer/désactiver la mise hors tension automatique

Afin de préserver la charge de la pile, l'appareil de mesure est programmé pour se mettre hors tension au bout de 30 minutes d'inactivité.

Remarque: La fonction de mise hors tension automatique peut être désactivée par l'entremise de l'application.

(Voir le Guide du logiciel REED Smart Series situé dans la section "Menu" de l'application pour plus de détails.)

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'application, y compris la configuration du taux d'échantillonnage, l'enregistrement des données, l'analyse des données, l'exportation et la génération de rapports, veuillez consulter le Guide du logiciel de l'application REED Smart Series à l'adresse www.REEDInstruments.com/cafr/smartseries

Remplacement des piles

Lorsque l'icône indicatrice de pile faible apparaît sur l'écran ACL, vous devrez remplacer les piles. Pour remplacer les piles, suivez les étapes suivantes:

1. Éteignez l'appareil.
2. Déverrouillez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil de mesure.
3. Retirez le couvercle de la batterie.
4. Remplacez les 4 piles de AAA.
5. Fixez le couvercle de la batterie et verrouillez-le en place.

Applications

- Entretien CVCA/R (Chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air/Réfrigération)
- Détection du blocage du filtre
- Débit de volume dérivé des registres d'air
- Surveillance du débit d'air des systèmes de ventilation
- Surveillance de la hotte de débit

Accessoires et pièces de rechange

CA-52A Étui de transport souple petit format

R8888 Étui rigide moyen format

R1500 Trépied

Vous ne trouvez pas votre pièce dans la liste ci-jointe? Pour obtenir une liste complète des accessoires et des pièces de rechange, veuillez visiter la page de votre produit à l'adresse www.REEDInstruments.com.

Entretien du produit

Pour conserver votre instrument en bon état de marche, veuillez suivre les directives suivantes:

- Remiser le produit dans un endroit propre et sec.
- Remplacer les piles au besoin.
- Si vous ne devez pas utiliser votre instrument pour une période de plus d'un mois, veuillez retirer la pile.
- Nettoyer votre produit et les accessoires avec un nettoyant biodégradable. Ne pas vaporiser le nettoyant directement sur l'instrument. Utiliser uniquement sur les pièces externes.

Garantie du produit

REED Instruments garantit cet instrument contre tout défaut de matériau ou de main d'œuvre pour un (1) an à partir de la date d'expédition. Au cours de la période de garantie, REED Instruments réparera ou remplacera sans frais les instruments ou pièces défectueuses en raison d'un matériau non conforme ou d'une erreur de fabrication, dans la mesure où l'instrument a été utilisé dans des conditions normales et entretenu adéquatement. L'entière responsabilité de REED Instruments se limite à réparer ou à remplacer le produit. REED Instruments ne sera pas tenu responsable des dommages causés à des biens ou personnes, s'ils sont causés par une utilisation non conforme de l'instrument ou si ce dernier est utilisé dans des conditions qui dépassent ses capacités prévues. Pour obtenir le service de garantie, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 1-877-849-2127 ou par courriel à info@reedinstruments.com et nous communiquer votre réclamation afin de déterminer les étapes nécessaires pour honorer la garantie.

Mise au rebut et recyclage du produit



Veuillez vous conformer aux lois et réglementations de votre région lorsque vous mettez ce produit au rebut ou le recyclez. Ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé séparément des déchets ordinaires.

REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com

Service après-vente

Pour toute question au sujet de ce produit, veuillez communiquer avec votre distributeur REED autorisé ou le service à la clientèle REED Instruments par téléphone au 1-877-849-2127 ou par courriel à info@reedinstruments.com.

Pour obtenir la dernière version de la plupart des guides d'utilisation, fiches techniques ou guides de produits, veuillez visiter **www.REEDInstruments.com**

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce guide d'utilisation est strictement défendue sans l'obtention préalable du consentement écrit de REED Instruments.

REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com

REED INSTRUMENTS



SMART
Series

✓ **Anémomètre à hélice**

✓ **Thermo-hygromètre**

✓ **Sonomètre**

✓ **Luxmètre**

✓ **Thermomètre à thermocouple**

Connectez-vous sans fil à votre téléphone intelligent ou à votre tablette grâce à l'**application REED Smart Series**

- ✓ La technologie Bluetooth^{MD} 5.0 assure la connectivité aux instruments jusqu'à une distance de 75m (246')
- ✓ Analysez les données et créez des rapports personnalisés pouvant être envoyés par courriel depuis un appareil mobile



REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com

REED INSTRUMENTS

TESTEZ ET MESUREZ
EN TOUTE CONFIANCE



Plus de 200 instruments de
test et de mesure portables

Accédez à notre
guide de produits



REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com

REED INSTRUMENTS

TEMPÉRATURE
& HUMIDITÉ



SON



HUMIDITÉ



VELOCITÉ D'AIR



ÉLECTRIQUE



REED Instruments

1-877-849-2127 | info@reedinstruments.com | www.reedinstruments.com